

Перечень Запасных Частей{XE "Spare Parts"}

7

Перечень Запасных Частей

Diese Ersatzteilliste entspricht dem technischen Stand Februar 1999.


This Parts List corresponds to the technical state of February 1999.

Этот Перечень Частей соответствует техническому состоянию на Февраль 1999.

Am Typenschild ist das Baujahr des Gasanalysengeräts (verschlüsselt) aufgeführt.

The rating plate shows the year of construction (coded) of the gas analyzer.

На идентификационной табличке указывается год конструирования газоанализатора (в закодированном виде).

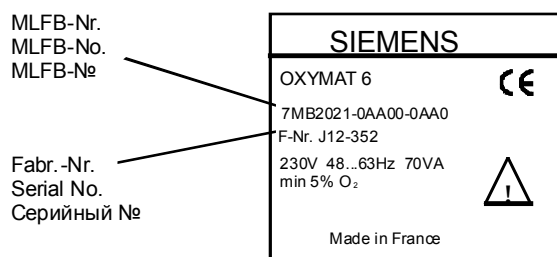

Hinweis für die Bestellung

Ordering instructions

Инструкция заказа:

Die Ersatzteilbestellung muß enthalten:

1. Menge
2. Bezeichnung
3. Bestell-Nr.
4. Gerätename, MLFB und Fabr.-Nr. des Gasanalysengerätes, zu dem das Ersatzteil gehört.

All orders should specify the following:

1. Quantity
2. Designation
3. Order No.
4. Name of gas analyzer MLFB-No. and Serial No. of the instrument to which spare part belongs.

Все заказы должны указывать следующее:

1. Количество
2. Обозначение
3. № заказа
4. Название газоанализатора, MLFB № и Серийный № прибора, к которому относятся заказываемые запасные части.

Bestellbeispiel:

Example for ordering:

Образец заказа:

2 МеЯкцпфе
C79451-A3460-B25
für OXYMAT 6
Typ 7MB2021-0AA00-0AA0
Fabr.-Nr. J12-352

2 Measuring heads
C79451-A3460-B25
for OXYMAT 6
type 7MB2021-0AA00-0AA0
Serial No. J12-352

2 Измерительные головки
C79451-A3460-B25
для OXYMAT 6
тип 7MB2021-0AA00-0AA0
Серийный № J12-352

Wir haben den Inhalt der Druckschrift auf die Übereinstimmung mit der beschriebenen Hard- und Software geprüft. Dennoch können Abweichungen nicht ausgeschlossen werden, sodaß wir für die vollständige Übereinstimmung keine Gewähr übernehmen. Die Angaben in dieser Druckschrift werden jedoch regelmäßig überprüft, und notwendige Korrekturen sind in den nachfolgenden Auflagen enthalten. Für Verbesserungsvorschläge sind wir dankbar.

We have checked the contents of this manual for agreement with the hardware and software described. Since deviations cannot be excluded entirely, we cannot guarantee full agreement. However, the data in this manual are reviewed regularly and any necessary corrections are included in subsequent additions. Suggestions for improvement are welcomed.

Мы проверили содержание этого руководства на согласованность с используемым аппаратным и программным обеспечением. Поскольку отклонения не могут быть полностью исключены, мы не можем гарантировать полную согласованность. Однако информация данного руководства регулярно просматривается, и необходимые изменения включаются в последующие издания. Приветствуются предложения по улучшению.

© Copyright Siemens AG - 1999 - All Rights reserved

© Copyright Siemens AG - 1999 - All Rights reserved

© Copyright Siemens AG - 1999 - All Rights reserved

Technische Änderungen vorbehalten

Technical data subject to change.


Техническая информация как объект для изменения

Weitergabe, sowie Vervielfältigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht gestattet, soweit nicht ausdrücklich zugestanden. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte vorbehalten, insbesondere für den Fall der Patenterteilung oder GM-Erteilung.

The reproduction, transmission or use of this document or its contents is not permitted without express written authority. Offenders will be liable for damages. All rights, including rights created by patent grant or registration of a utility model or design, are reserved.


Не допускается воспроизведение, передача или использование данного документа или его содержания без специального письменного разрешения. Все права, включая права создаваемые выдачей патента или регистрацией усовершенствованной модели или дизайна, защищены.

Übersicht Baugruppen / Overview / Общий Вид
OXYMAT 6 (7MB2021, 7MB2011)

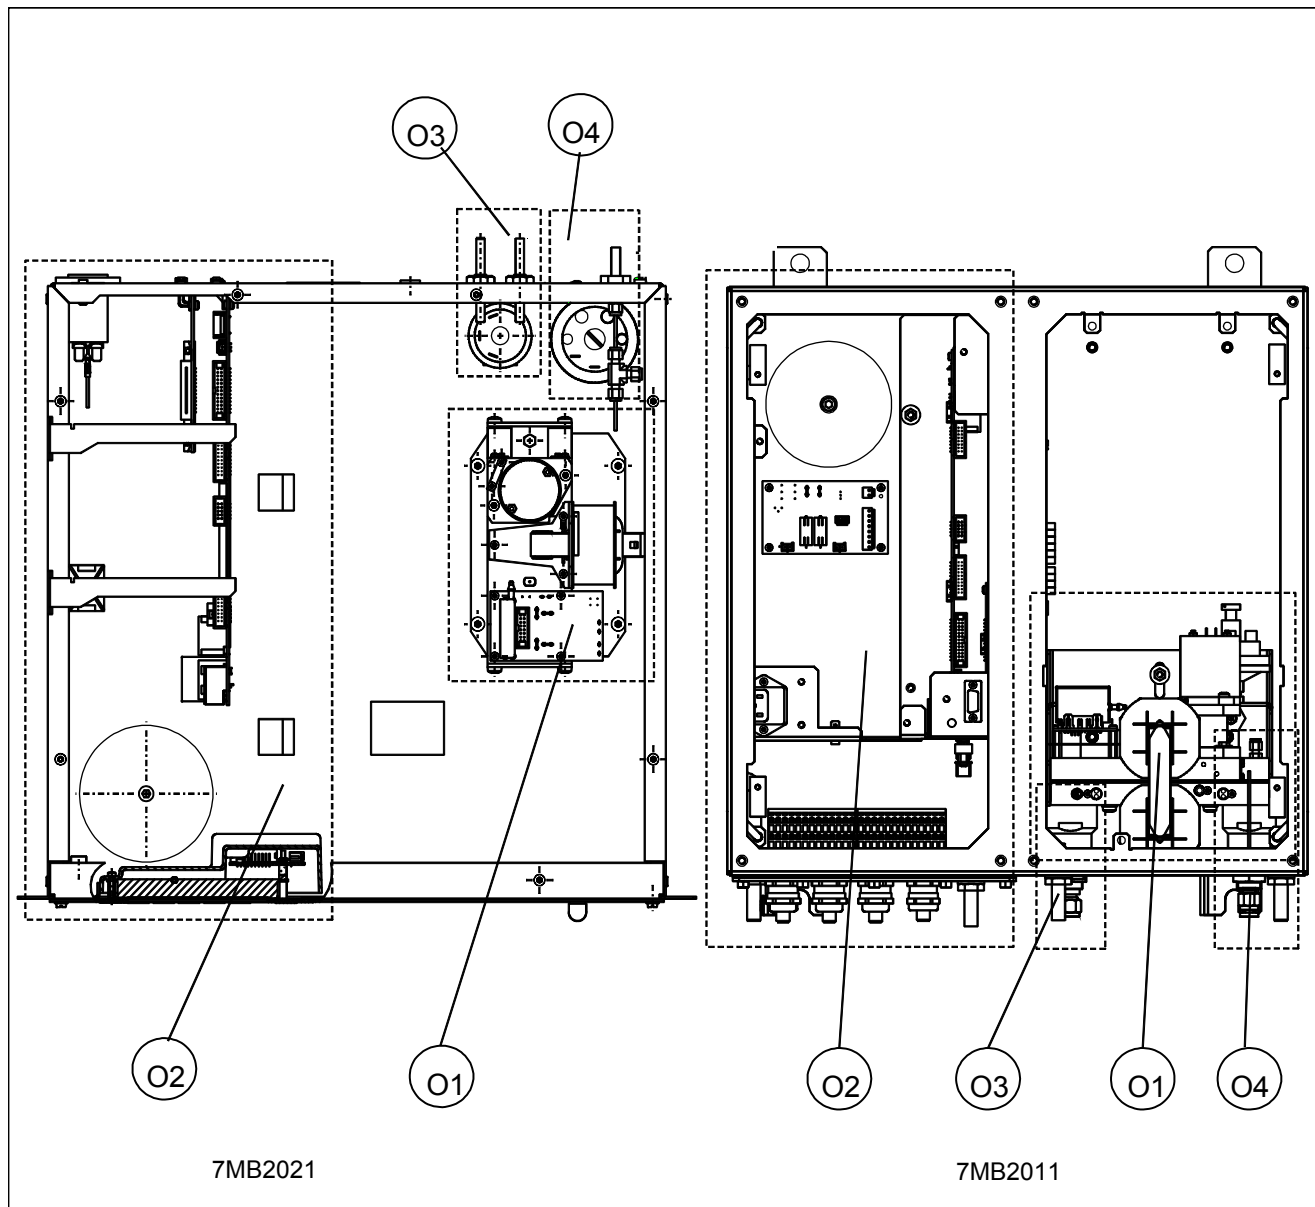

O1	Analysierteil Analyzer section Анализаторная секция
O2	Elektronik Electronics Электроника
O3	Meßgasweg Hosing system for sample gas Трубопровод анализируемого газа
O4	Vergleichsgasweg Hosing system for reference gas Трубопровод эталонного газа


Übersicht Baugruppen / Overview / Общий Вид
ULTRAMAT 6 (7MB2121, 7MB2111)

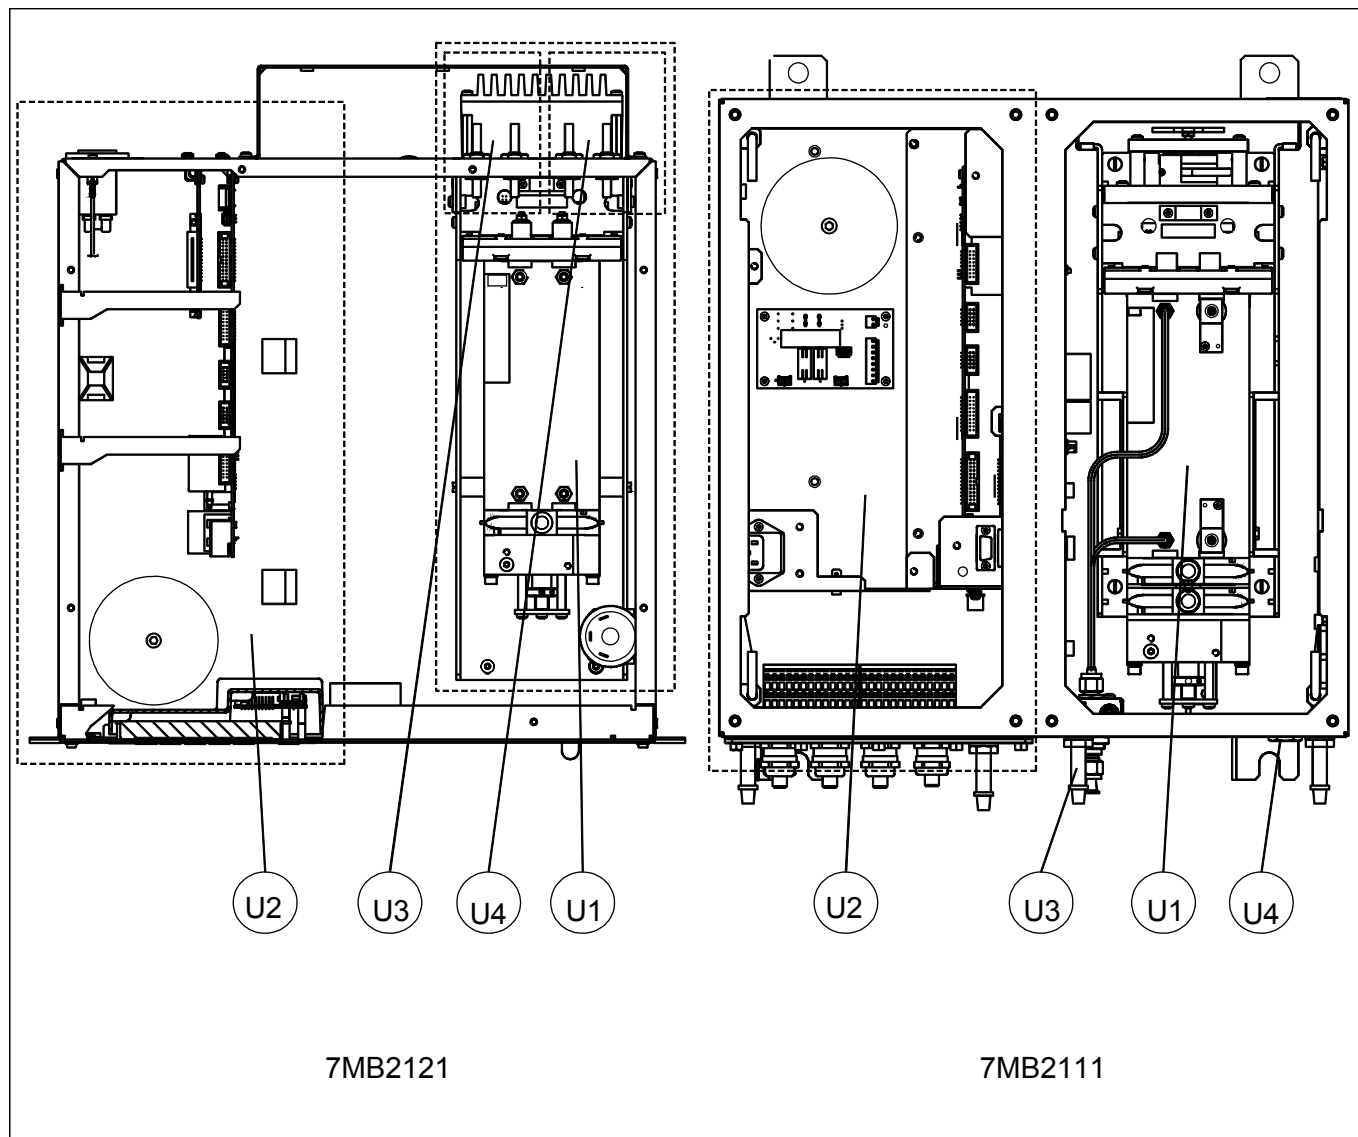


U1	Analysierteil Analyzer section Анализаторная секция
U2	Elektronik Electronics Электроника
U3	Meßgasweg Hosing system for sample gas Трубопровод анализируемого газа
U4	Vergleichsgasweg Hosing system for reference gas Трубопровод эталонного газа

Übersicht Baugruppen / Overview / Общий Вид


ULTRAMAT/OXYMAT 6 (7MB2023)

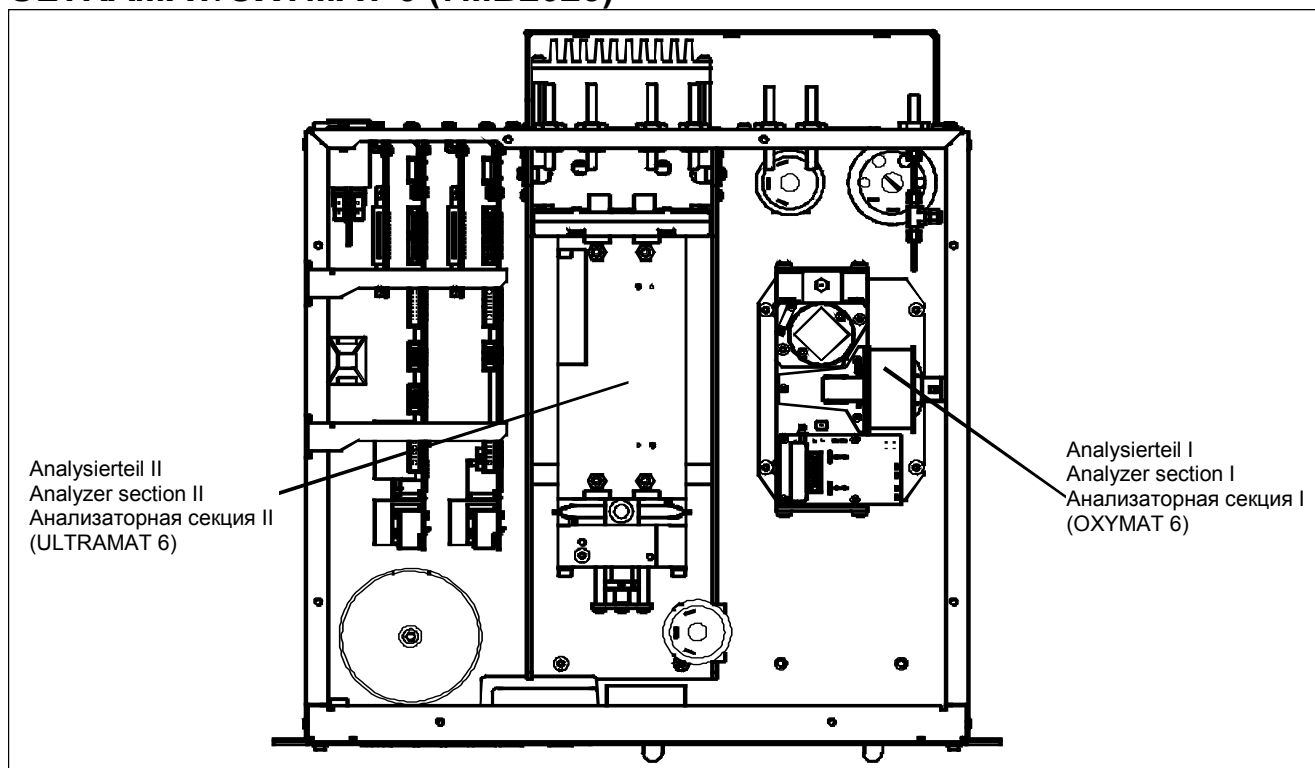

ULTRAMAT/ULTRAMAT 6 (7MB2123)

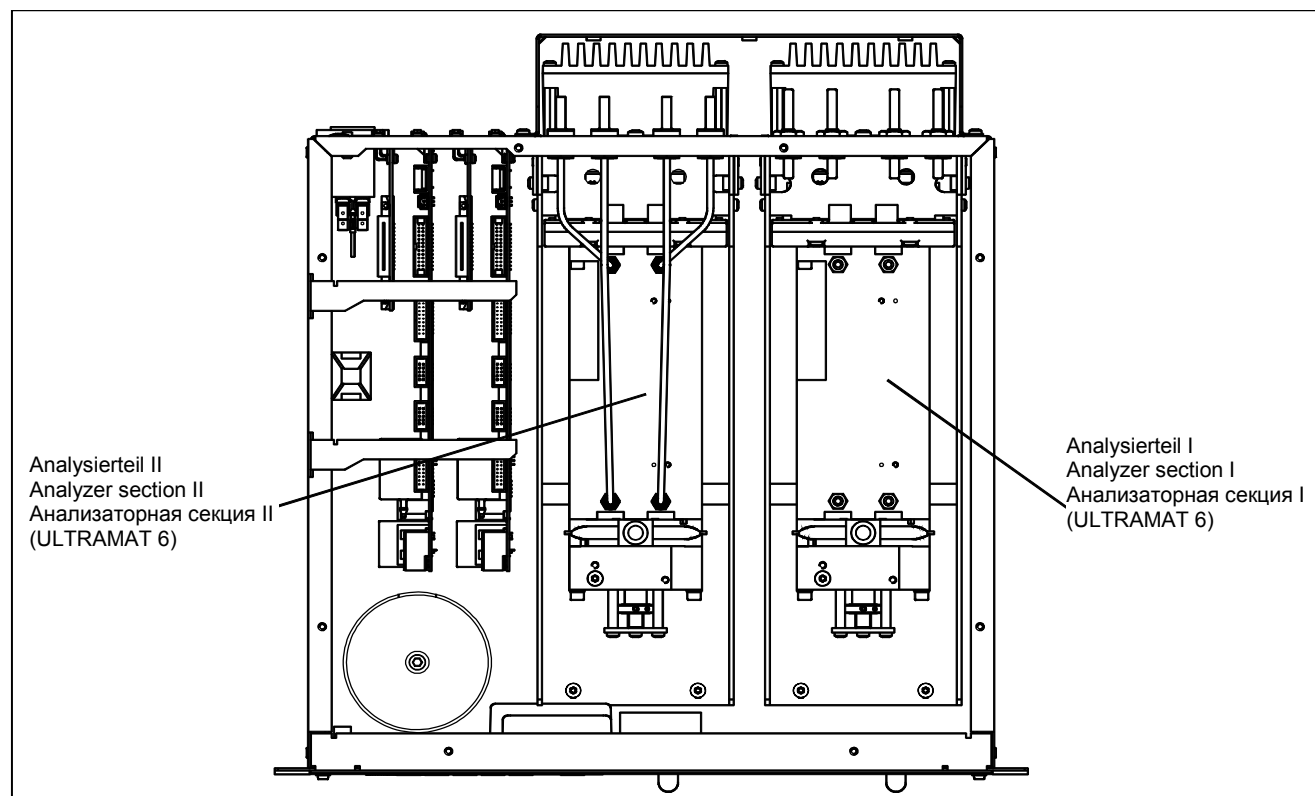

Analysierteil / Analyzer section / Анализаторная Секция **ОХУМАТ 6**

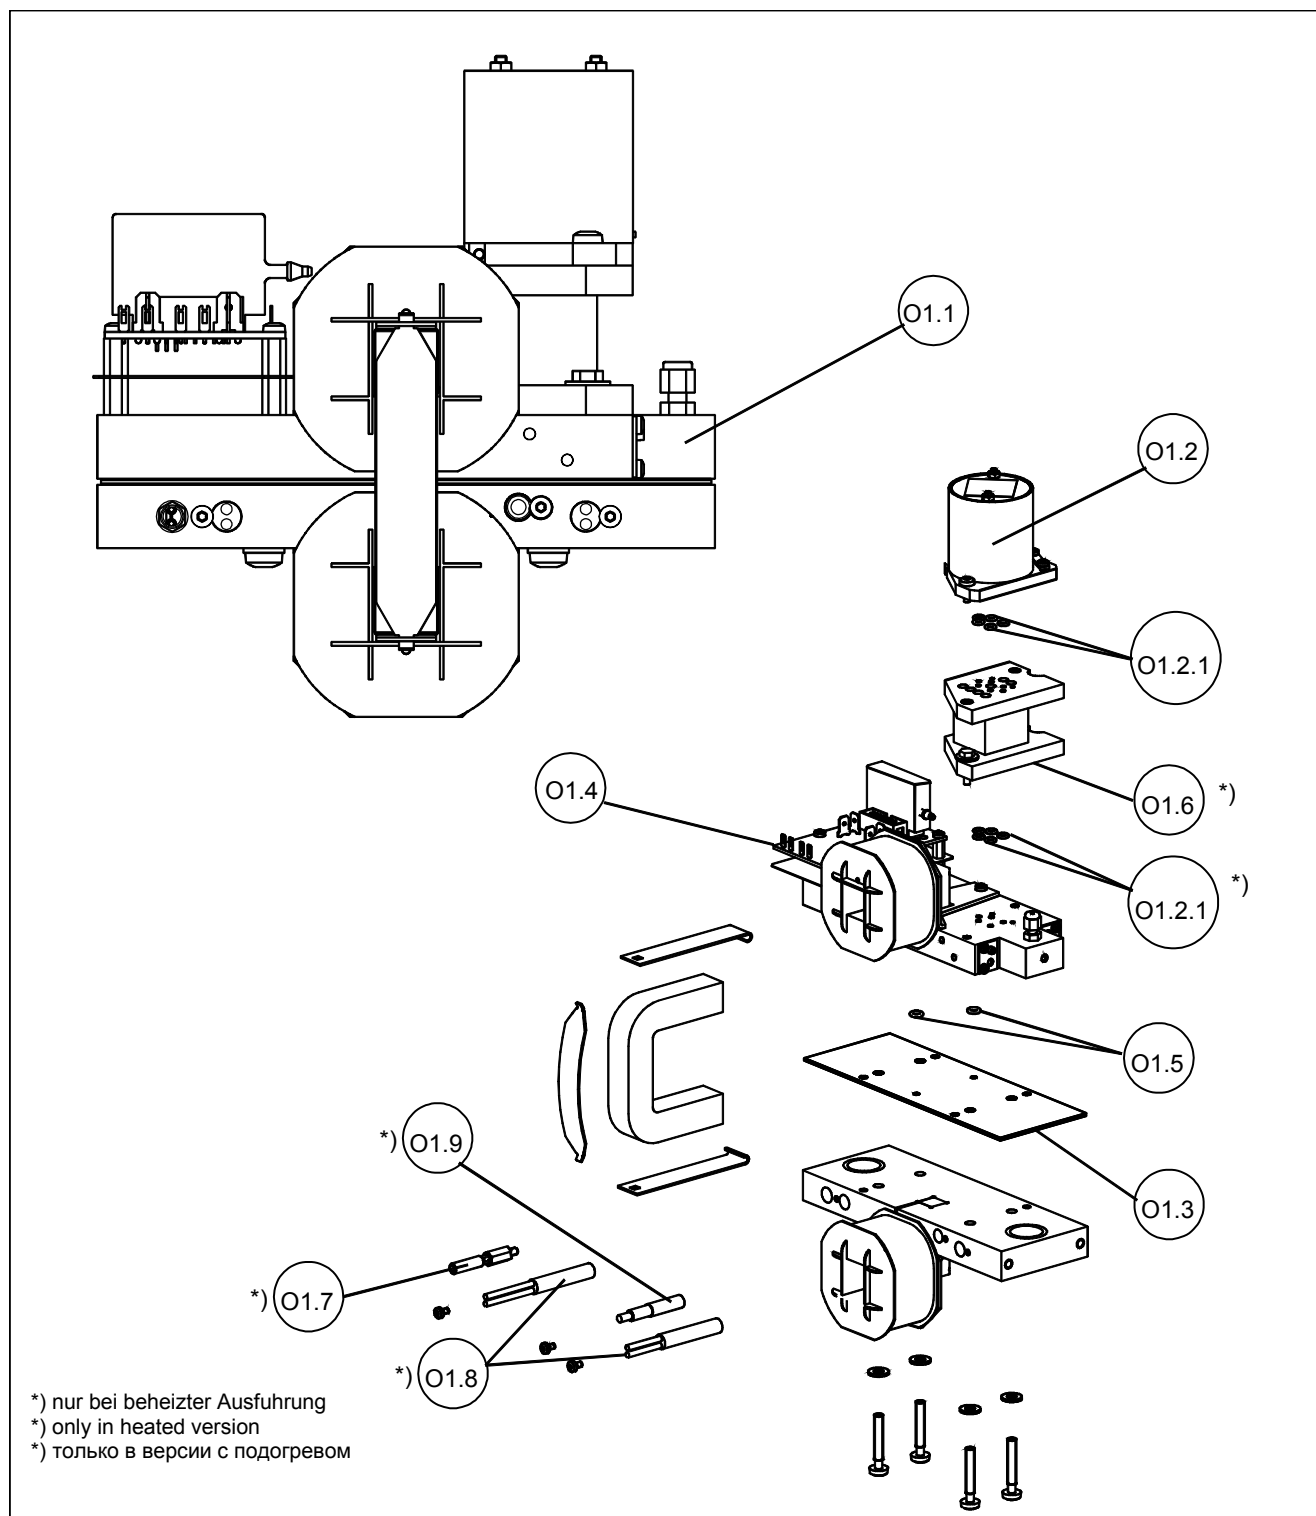

Bezeichnungen siehe Seite 7-8

Designation see page 7-8

Обозначение см. на стр. 7-8